


1 使用 VIDAS Easy SLM检测



2 使用 标准方法确认

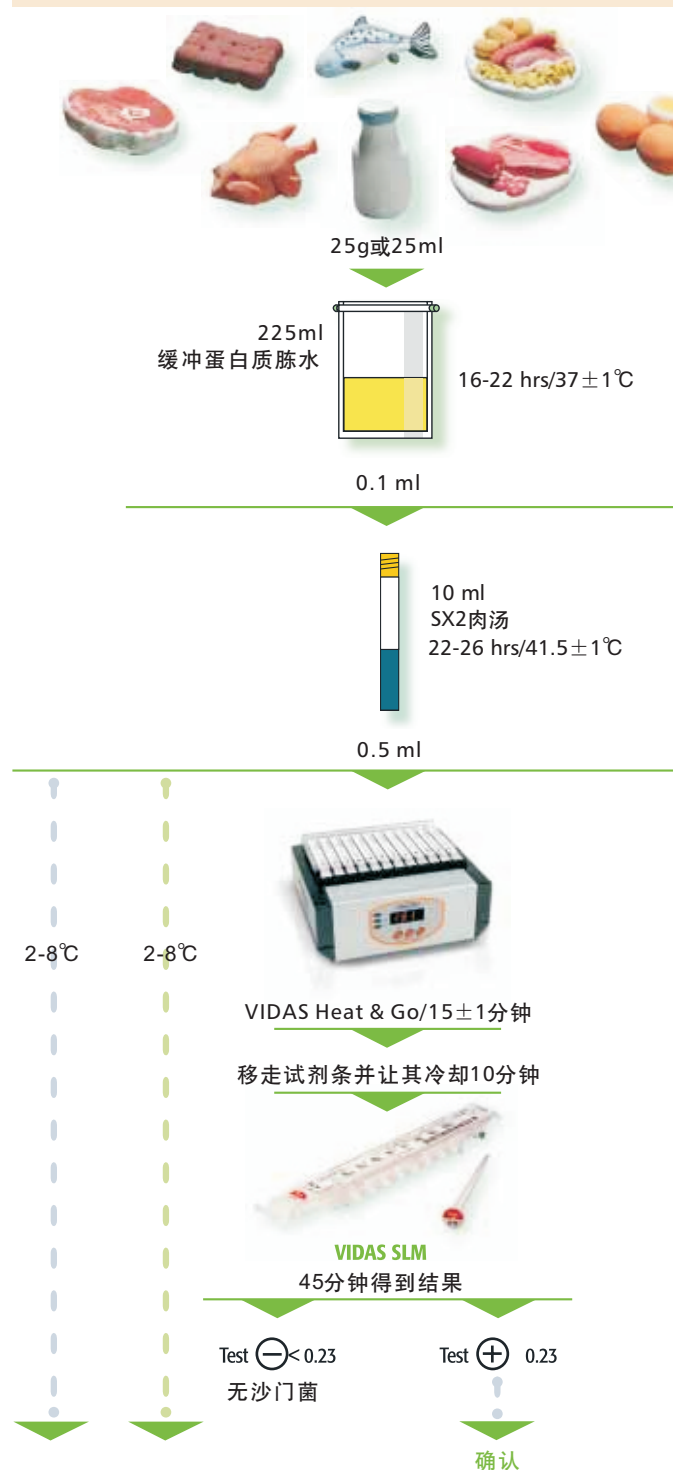

沙门菌系列

42043	缓冲蛋白胨水	6 × 225ml
51094	缓冲蛋白胨水	500g
42121	SX2肉汤	20 × 10ml
43621	chromID Salmonella	20平板/盒
43563	XLD平板	20平板/盒
43564		100 平板/盒
43111	Hektoen-琼脂	20 平板/盒
20100	API 20E	25条/盒
21341	VITEK GN卡	20张/盒
30702	VIDAS Salmonella	60 测试/盒
93555	VIDAS Heat & Go	230伏

请参阅产品说明书以进一步获得详细信息